


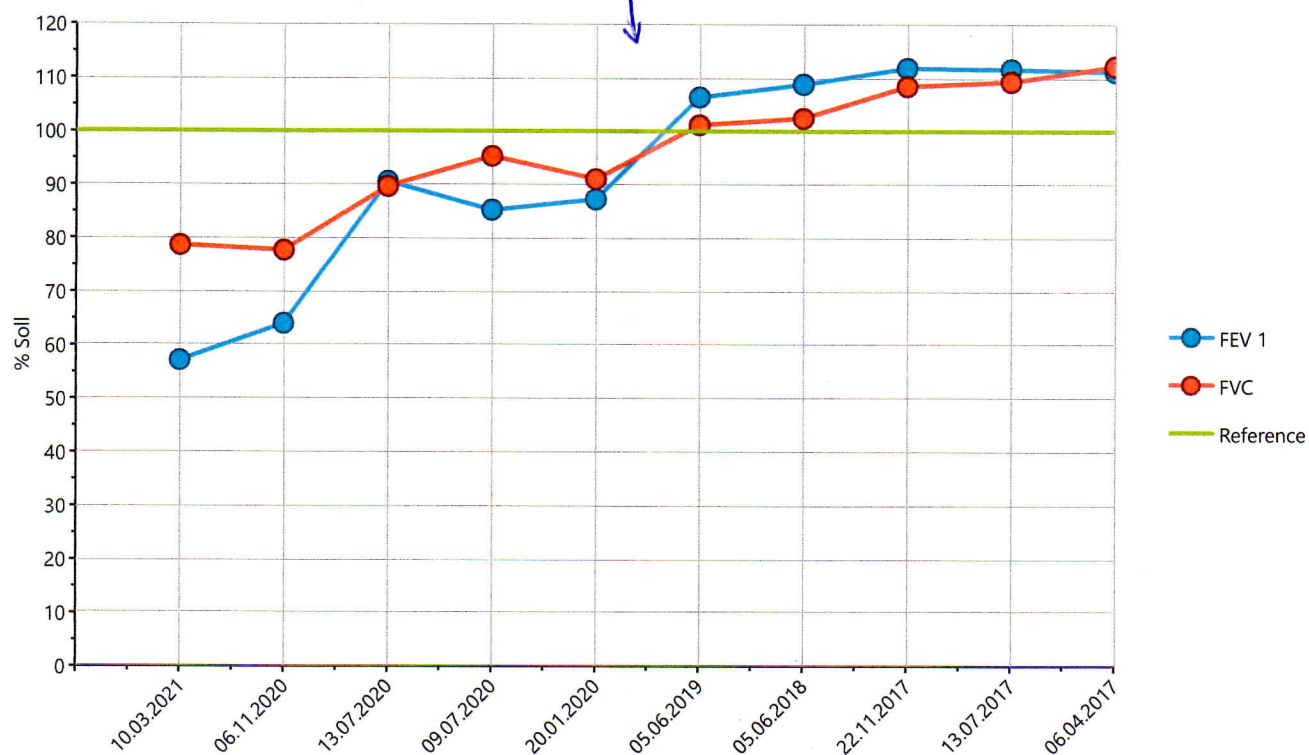

	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Datum	10.03.21	06.11.20	13.07.20	09.07.20	20.01.20	05.06.19	05.06.18	22.11.17	13.07.17	06.04.17
Zeit	11:40	12:14	12:05	11:47	10:05	11:35	13:52	11:43	11:36	11:06
Raw tot kPa*s/L	0,49	0,40	0,26	0,28	0,25	0,19	0,19	0,18	0,15	0,19
TGV L	4,62	4,54	3,97	4,37	4,80					
RV L	4,46	3,79	3,38	4,26	4,74	3,24	3,60	3,15	3,27	3,09
TLC L	7,50	7,01	7,36	7,93	8,34	7,39	8,06	7,47	7,75	7,64
VC IN L	3,04	3,21	3,98	3,60	3,60	4,15	4,27	4,32	4,48	4,56
FVC L	3,00	2,97	3,45	3,67	3,51	3,93	4,02	4,25	4,32	4,44
FVC IN L	3,04	3,21	3,98	3,60	3,60	4,15	4,27	4,32	4,47	4,56
FEV 1 L	1,65	1,85	2,65	2,49	2,55	3,14	3,25	3,34	3,37	3,36
FEV1%VCmax %	54,32	57,55	66,42	67,78	70,80					